


COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE

Selbstentnahme eines Nasen-Abstrichs unter Anleitung


1




2

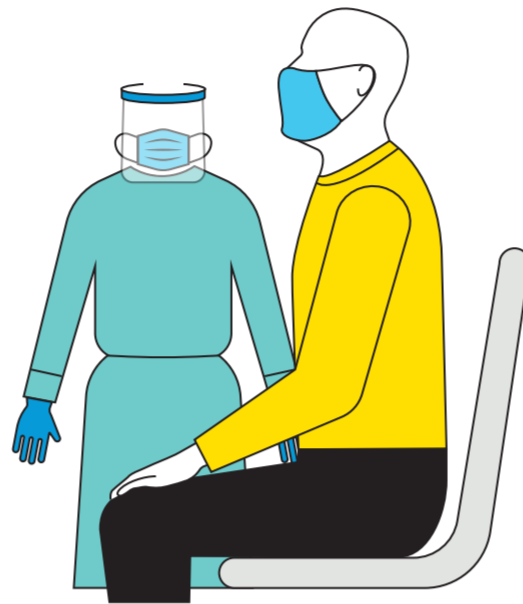


3

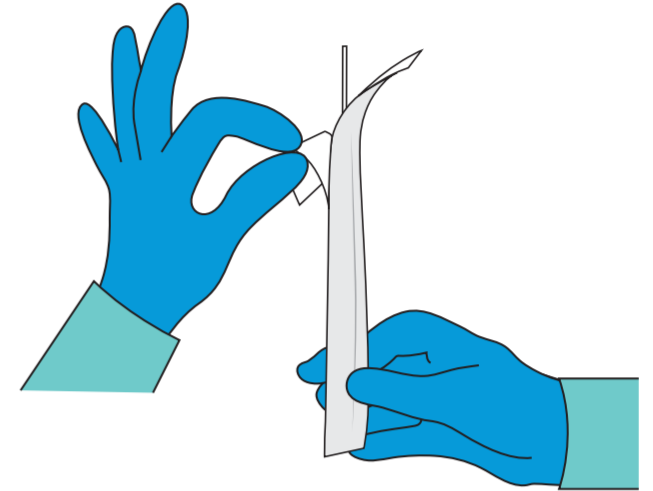


4

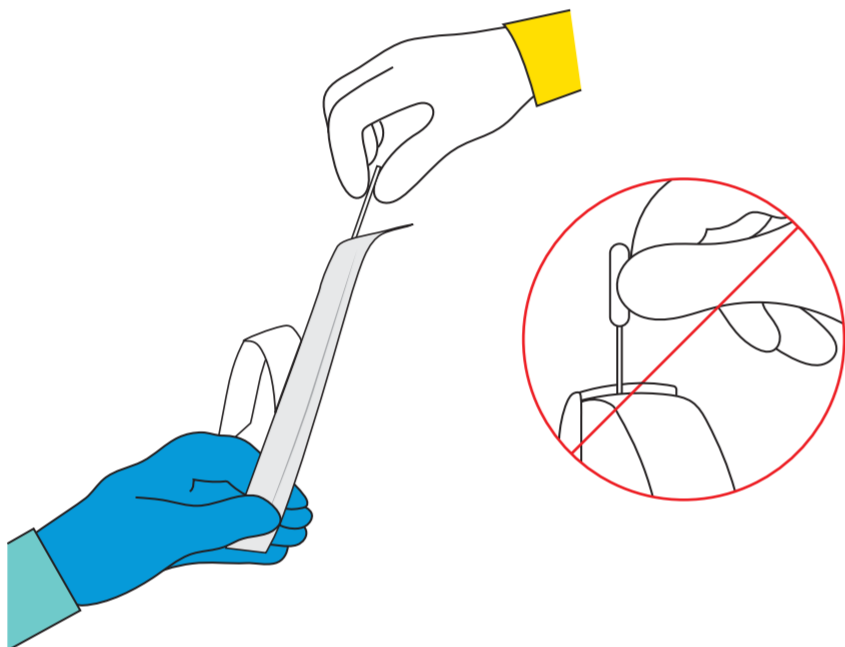


5

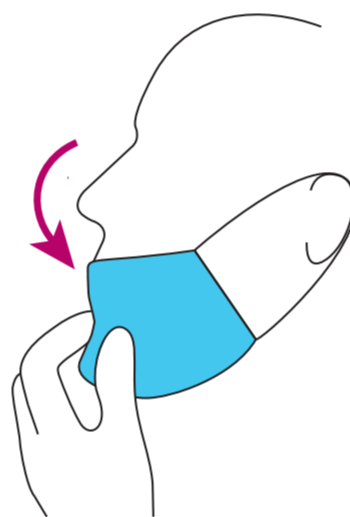


6

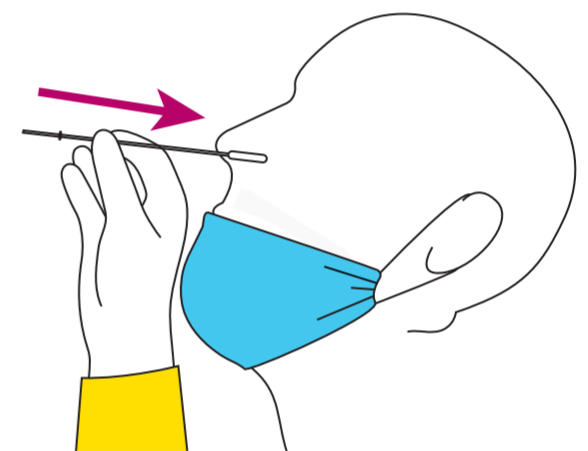


7

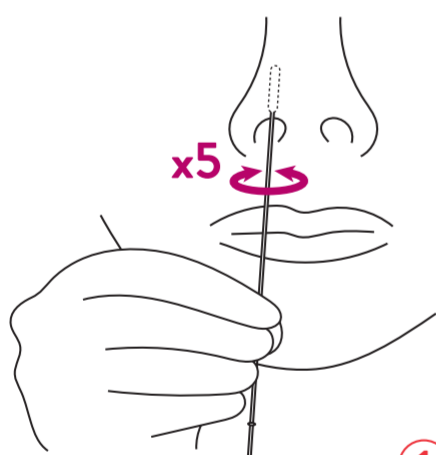


8

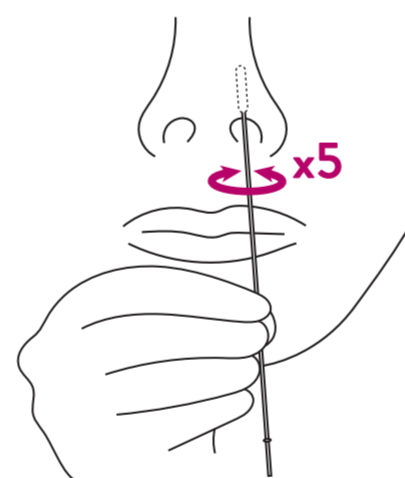

9

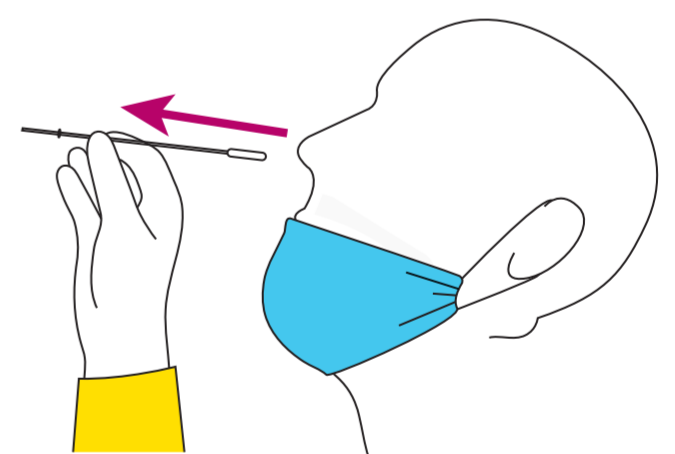

10

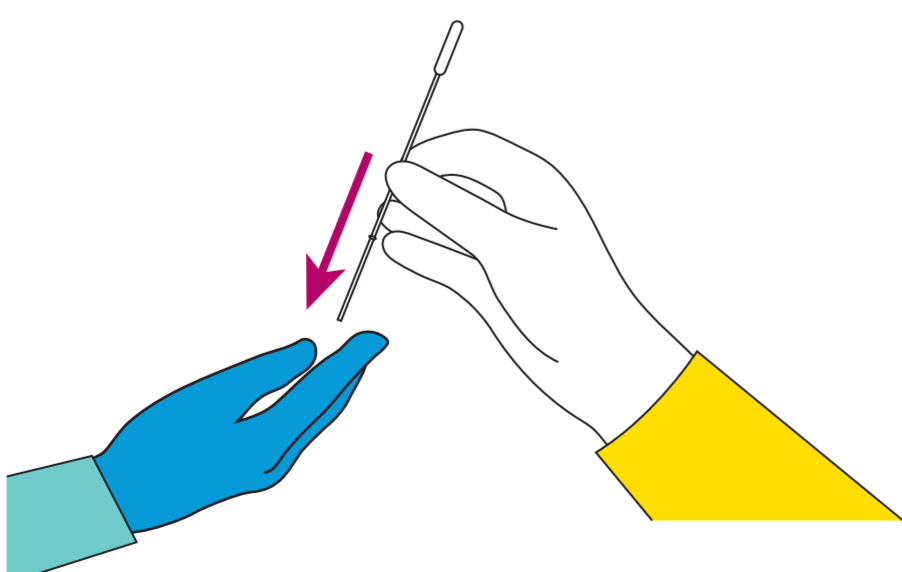

11

